Confidential





Das Registrierungsformular wird angezeigt, wenn das

[Awibiddengolage]-Bangeetebbt Lizenzbereich angeklickt wed, wie in

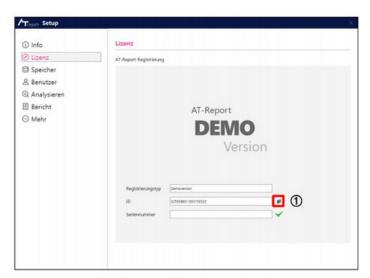



Abbildung 1.15 Lizenzierungsbereich

Wenn der Benutzer nach der Eingabe der Informationen auf das Symbol ②In Zwischenablage kopieren in [Abbildung 1.16] klickt, wird der Inhalt kopiert. Die kopierten Informationen sind an senden und alle eingegebenen Benutzerinformationen werden gesendet.



Abbildung 1.16 Zwischenablage-Symbol zum Kopieren des Anmeldeformulars und der ID



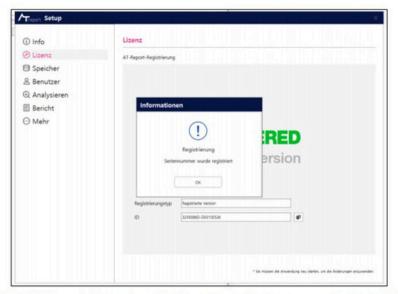

Nach Erhalt der Seriennummer, die einer von ATsens Co., Ltd. (medizintechnik@praxisdienst.de) ausgestellten ID entspricht, geben Sie die Seriennummer in das Feld Seriennummer unter dem Feld ID ein und klicken Sie dann auf das Symbol Bestätigen (), wie in [Abbildung 1.15] gezeigt.

Wenn eine korrekte Seriennummer eingegeben wurde, werden ein entsprechendes Symbol und eine Meldung angezeigt, die auf dem Typ der Seriennummer basieren, wie in [Abbildung 1.17] dargestellt.

Abbildung 1.17 Bildschirm des Eingabeergebnisses für die Seriennummer der Registrierungsversion

The RegistrationFormwindowisgeneratedwhenthe

(HigboardionintheLicensesectionisclicked, asshownin 1)

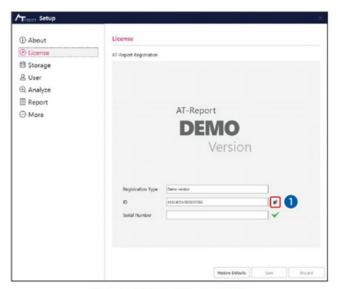


Figure 1.15 Setup License section

Oncetheuserclicksthe **2**CopytoClipboardiconin[Figure 1.16] afterenteringtheinformation, thecontentiscopied. The copied information is to be sent to ATsens Co., Ltd. (medizintechnik@praxisdienst.de) via email, and all of the entered user information is sent.



Figure 1.16 Clipboard icon for copying the Registration Form and ID



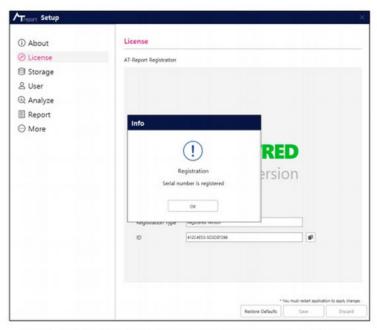


Figure 1.17 Registration version serial number input result screen

Upon receiving the serial number, which is equivalent to an ID issued by ATsens Co., Ltd.

(medizintechnik@praxisdienst.de), enter the serial number in the Serial Number field located below the ID (*) field and then click the Confirm icon () as shown in [Figure 1.15]. Ifacorrectserialnumberisentered, acorrespondingicon and messagewillbedisplayed, basedontheserialnumber type as shown in [Figure 1.17].

Confidential

