


MED-340/ LABO-340/ LABEX-340 ab SN 26450

Maßangaben

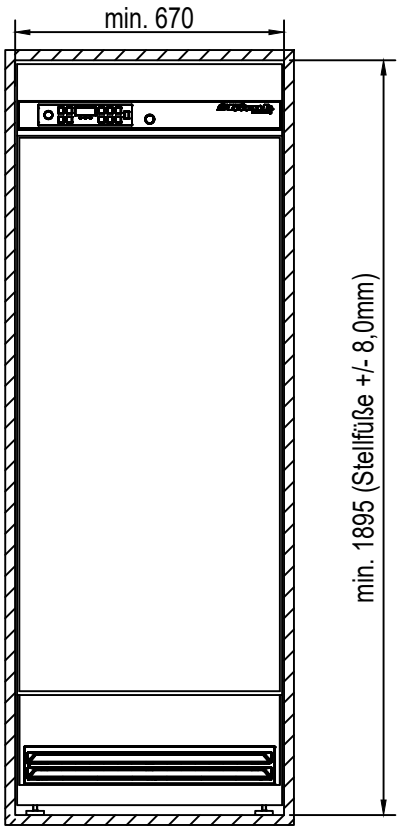


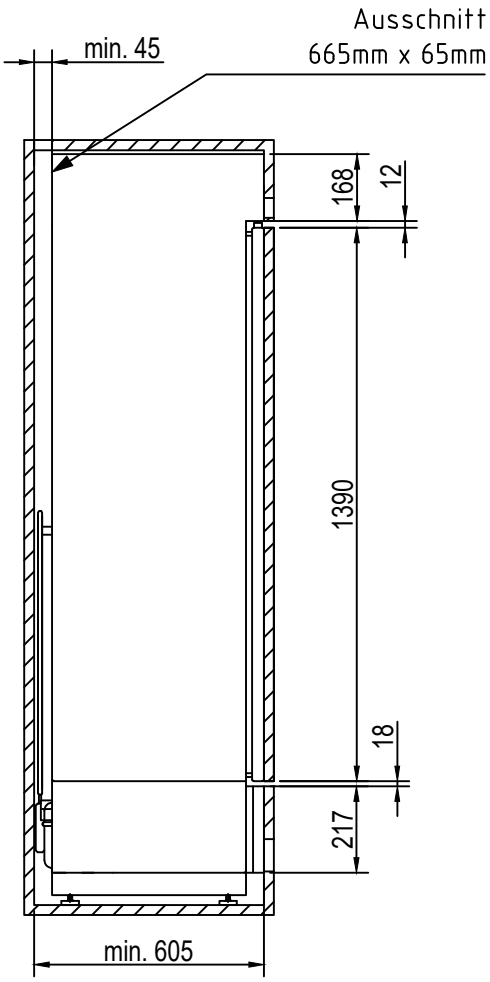


Wenn der MED/ LABO/ LABEX eingebaut wird und es notwendig ist das Bedienteil auf die Möbelfront zu Montieren, entfällt die Funktion vom Schloss.
Um das Loch in dem Bedienteil zu Schließen wird ein Blindstopfen eingesetzt. (bestellen Firma Kirsch)

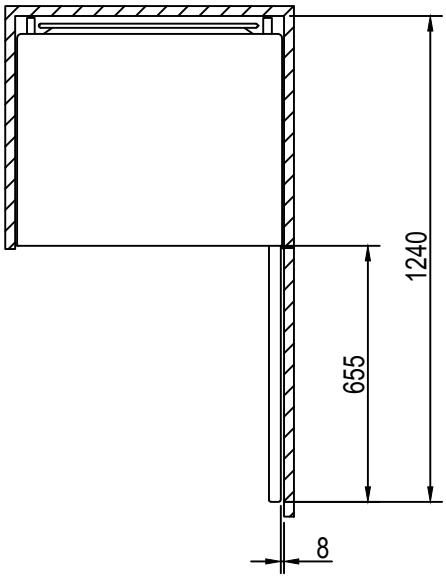

Ausschnitt Elektronikraumblende

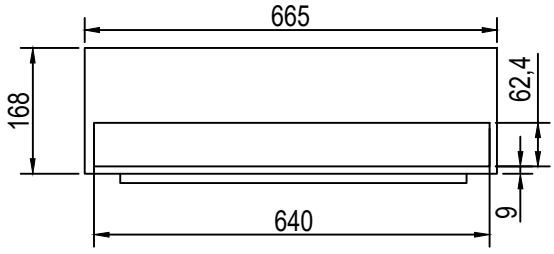

Ausschnitt Maschinenraumblende

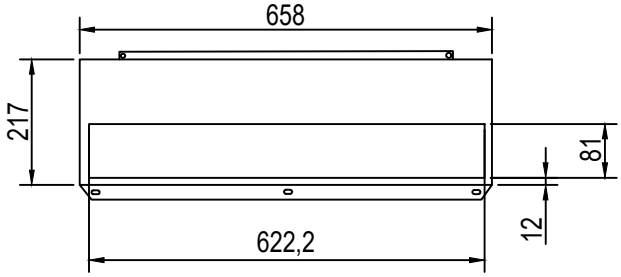

Zeichng. Nr. 340-083-0