


**Süsse Labortechnik GmbH & Co. KG**
Kasseler Str. 76
34281 Gudensberg
GERMANY
+49 (0) 5603 502-0
+49 (0) 5603 502-19
info@suesse.de
**www.suesse.de**

# Artikel / Article: 11308

## Technisches Datenblatt / Technical Datasheet

Druckdatum / Print:
Dezember 2020

REF: 01

## Pasteurpipette, Ø5x150mm, Graduierung, Vol. 1ml

**Artikelbeschreibung / Article Descripiton**

| **Produkteigenschaften<br>Product characteristics** | |
|---|---|
| **Durchmesser / Diameter<br>Probengefäß / Sample container** | 5 mm |
| **Länge / Lenght<br>Probengefäß / Sample container** | 150 mm |
| **Nennvolumen / Volumen<br>Probengefäß / Sample container** | 1 ml |
| **Material** | PP |
| **Gewicht des Produktes / Weight** | 1,2g |

| **Verpackung<br>Packing** | |
|---|---|
| **Mindestbestellmenge<br>Stück<br>Minimum order quantity<br>PCS** | 3.000 |
| **Stück pro Innenverpackung<br>PCS per inner box** | 500 |


# Produktname

## Technisches Datenblatt

**Süsse Labortechnik GmbH & Co. KG**
Kasseler Str. 76
34281 Gudensberg
GERMANY
+49 (0) 5603 502-0
+49 (0) 5603 502-19
info@suesse.de
**www.suesse.de**

| | |
|---|---|
| **Stück pro Umkarton**<br>**PCS per outer carton** | 3.000 |
| **Stück pro Palette (Europal)**<br>**PCS per Palett** | 72.000 |

| **Zertifizierung**<br>**Certificate** | |
|---|---|
| **Produkt MPG / IVD**<br>**Product MDR / IVD** | IVD |
| **RNase-, DNase-, &**<br>**DNA- Pyrogenfrei / Free** | Nein<br>No |
| **LOT.- Nr.** | Ja<br>Yes |
| **CE-Zertifizierung** | CE |

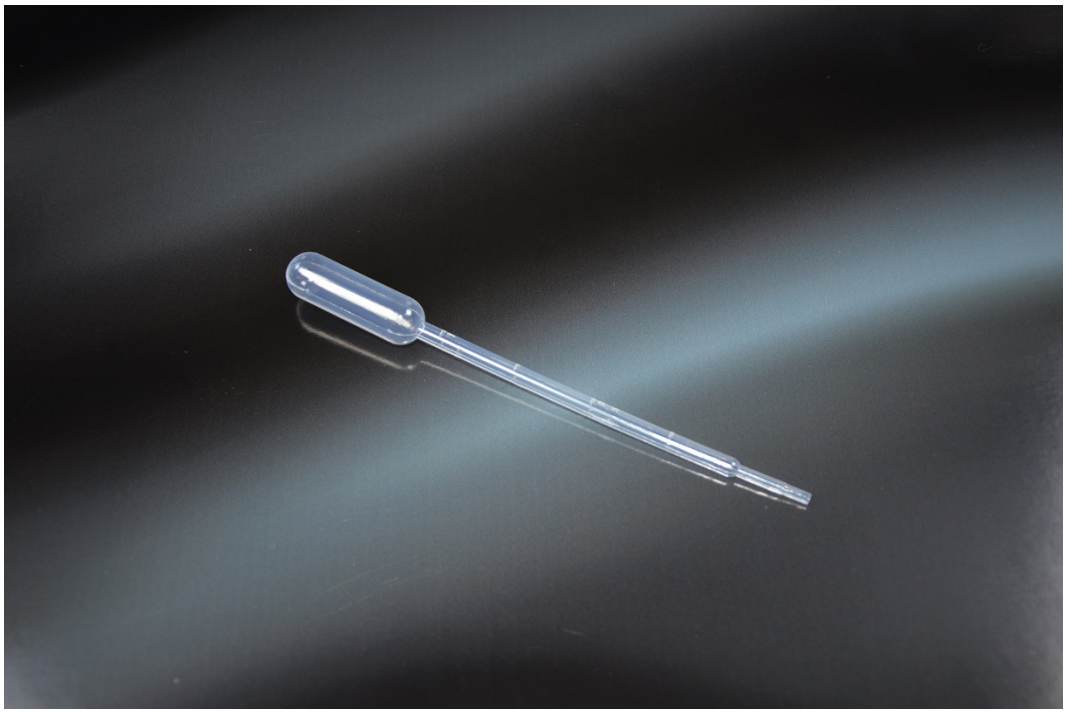

Druckdatum / Print:
Dezember 2020

REF: 01